





LECO ハイスピード 酸素分析装置 RO-17型
分析時間 35秒

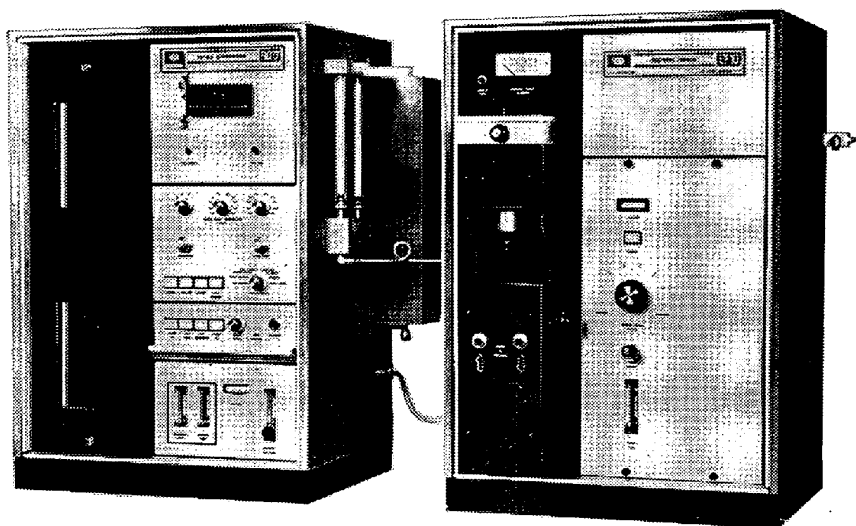

分析時間	35秒
分析範圍	1ppm～2000ppm
精 度	±2ppm
抽出溫度	2800℃
全 自 動	重量補正
	標準化機構內藏
密閉冷却	給排水不要

分析時間 40秒

秤量→投入→分析→プリントアウト 55秒

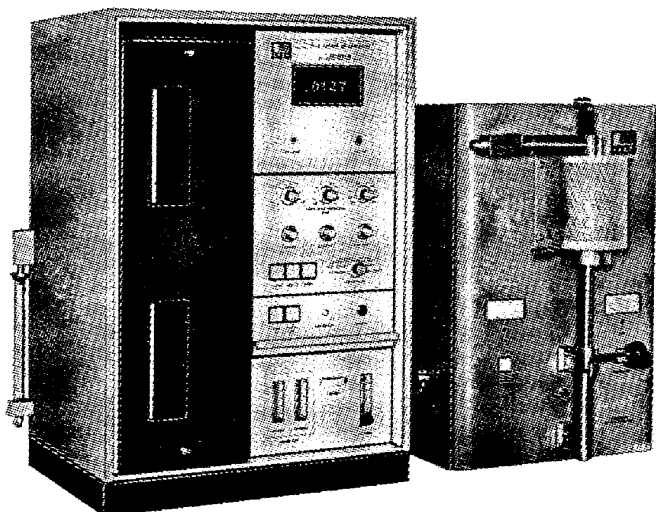

分析時間 40秒
分析範囲 1ppm～5%
精 度 ±0.0002
自動天秤、プリンター、コン
ピュータ接続が出来ます。

日本總代理店



日本アナリスト株式会社

本社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) TEL(03)493-7281(代)
大阪営業所 〒560 大阪府豊中市北桜塚 3-7-15 TEL(06)849-7466

編集兼発行人 東京都千代田区大手町一、九、四經団連会館内
印刷 東京都板橋区熊野町 十三十一 倉田 新太郎
直 則

行 所 東京都千代田区大手町一丁目九番四号
経 団 連 会 館 三 階 法人団 日本鉄鋼協会
電話 東京(二七九)六〇二一(代表)
振替 貯金 口座 東京一九三番

(郵便番号一〇〇)
(分譲価格一二〇〇円)
会 員 無 料